

お得意様 各位

光製薬株式会社  
東京都台東区今戸 2-11-15

## 容器形状変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記プラスチックアンプル製剤の容器形状・寸法及び個装・梱包ケース寸法（炭酸水素 Na 静注 7%PL「フソー」は除く）を変更させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

尚、統一商品コード、JAN コード、薬価基準収載医薬品コード、製剤の組成、効能・効果、用法・用量につきましては、従来品と変更はございません。

今後ともより一層のご愛顧、ご高導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 記


#### 変更箇所

- プラスチックアンプルの容器形状・寸法変更
- 個装・梱包ケースの寸法変更（炭酸水素 Na 静注 7%PL「フソー」は除く）

#### 変更開始 Lot 及び出荷予定時期

製品名	容量・包装	統一商品コード JANコード	個装ケース寸法(mm)	変更開始 Lot	出荷 予定時期
			梱包ケース(6入)寸法(mm)		
塩化ナトリウム注 10%「フソー」	20mL × 50 管 プラスチックアンプル	186 72804 0 4987 186 72804 0	141 × 267 × 87.5	90509C	2009年 8月中旬
			281 × 441 × 188		
ブドウ糖注 50%PL「フソー」	20mL × 50 管 プラスチックアンプル	186 72604 6 4987 186 72604 6	141 × 267 × 87.5	90514C	2009年 9月下旬
			281 × 441 × 188		
炭酸水素 Na 静注 7%PL「フソー」	20mL × 50 管 プラスチックアンプル (プリスター包装品)	186 72904 7 4987 186 72904 7	209 × 239 × 144(変更なし)	未定	2010年 秋頃
			251 × 437 × 303(変更なし)		

#### プラスチックアンプルの容器形状・寸法変更

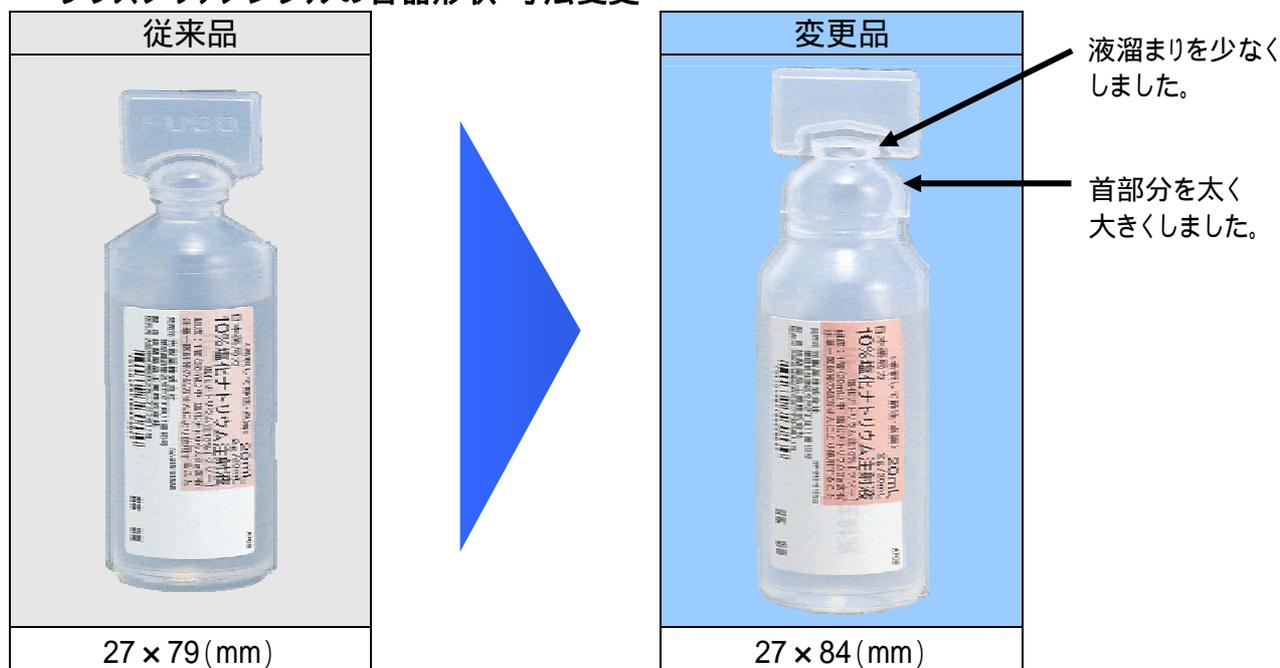

変更開始 Lot には包装箱に「**包装変更品**」と表示致します。

流通在庫の関係から当該製品がお手元に届くまで若干の遅れが生じますが何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

以上