

## 包装変更のご案内

製  
品環状型非イオン性MRI用造影剤  
ガドテリドール静注シリンジ  
17mL「HK」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品につきまして、下記のとおり、包装を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

なお、製剤の組成、効能・効果、用法・用量につきまして変更はございません。今後ともより一層のご愛顧、ご高導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記


## ■ 変更内容

● 製品ラベルのデザインを変更  
(製造番号および使用期限の印字方法をレーザー印字に変更)

## ■ 変更開始ロット及び出荷予定時期・各種コード

製品名	容量・包装	統一商品コード	変更開始ロット (使用期限)	出荷予定時期
ガドテリドール静注シリンジ 17mL「HK」	17mL×5筒	186 16502-9	H2YAHS (2025. 11)	2023年3月

## ■ 製品ラベル

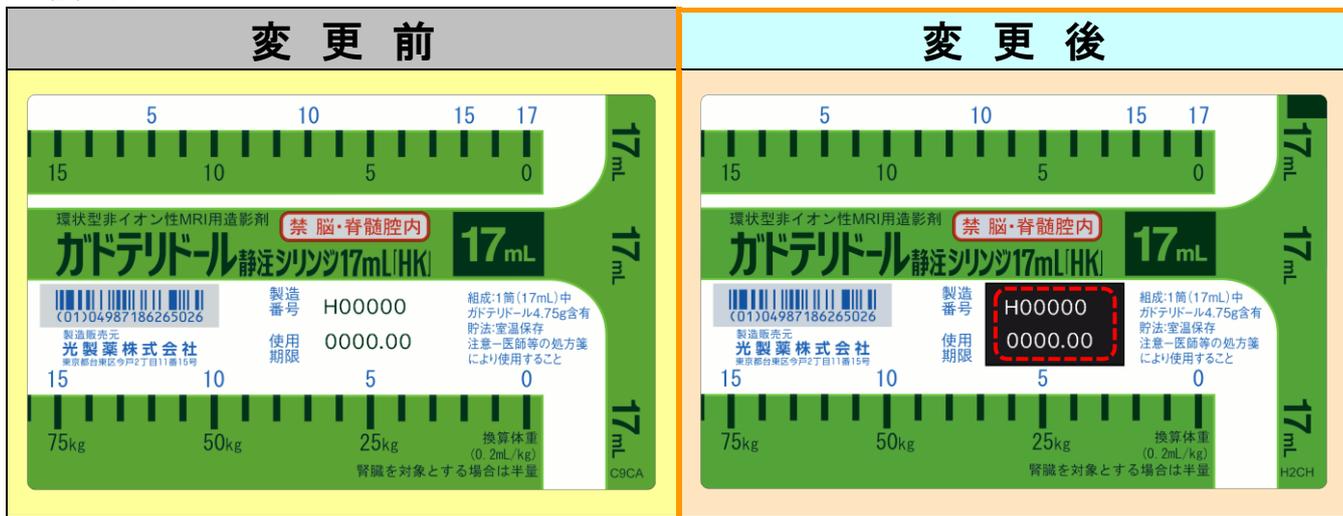

※当面の間、包装箱に「ラベル変更品」と記載いたします。

※流通在庫の状況により当該製品がお手元に届くまで若干の前後が生じますが何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

以上